SECADORAS DE MANOS

AUTOMÁTICA	Dualflow Plus



M14A
Acabado blanco



M14ACS
Acabado satinado



M14AB
Acabado negro

Descripción general

- Secadora de manos tipo “hands in” de nueva generación, rápida eficiente y de diseño elegante.
- 2 pares de sensores infrarrojos en ambos lados de los embellecedores exteriores para el accionamiento automático.
- Velocidad máxima de salida del aire a 410 Km/h.
- Secado de las manos en 8-15 segundos.
- Motor de potencia ajustable que permite regular el consumo energético (entre 420 y 1.100W).
- Desconexión automática a los 30 segundos de uso continuado.
- Bajo nivel sonoro en su categoría (62 dBA en modo ECO).
- Adecuada para lugares de alta frecuencia de paso.
- Fácil mantenimiento.

Componentes y materiales


- **M14A:** carcasa de ABS, acabado blanco.
- **M14ACS:** carcasa de ABS, acabado satinado.
- **M14AB:** carcasa de ABS, acabado negro.
- Motor universal de escobillas de alta presión clase F, ajustable entre19.000 y 30.000 rpm.
- Resistencia calefactora mínima de 400 W con interruptor “ON/OFF” para su conexión/desconexión.
- Base fabricada en plástico resistente al fuego PA6V0
- Protección antimicrobiana y antibacteriana Biocote® basada en la tecnología de iones de plata. Estos iones inhiben la reproducción de micro-organismos en el producto durante toda su vida útil.
- Medio filtrante HEPA que filtra las partículas sólidas en suspensión (polen, ácaros del polvo, humo del tabaco, etc) mejorando notablemente la calidad del aire.
- Depósito de agua extraíble, dispone de válvula para el vaciado.
- Opción de conexión al desagüe de la instalación principal de agua (KIT Cod.: KITDESM14A).
- Leds luminosos frontales par a un rápido diagnóstico de la secadora (verde - máquina en funcionamiento, azul - tanque lleno, rojo - revisar motor).
- Aviso óptico y acústico de tanque lleno.
- Neutralizador de olores (opcional).

Especificaciones técnicas

Tensión	*220- 240 V*
Frecuencia	*50/60 Hz*
Aislamiento	*Clase I*
Potencia total	*420 – 1.500 W*
Consumo	*3,2 – 6.4 A*
Potencia del motor	*420 – 1.100 W*
Rpm	*19.000 – 30.000*
Potencia de la resistencia	*400 W (con interruptor “ON/OFF”)*
Dimensiones	*665x320x228 mm*
Peso	*8,3 Kg*
Espesor de la carcasa	*3 mm*
Tiempo de secado	*8-15 seg.*
Flujo de aire efectivo	*94-165m3/h –1.570-2.750 l/min*
Velocidad del aire	*234 – 410 Km/h*
Temperatura del aire (10 cm distancia/21^{O}C)	*40 ºC*
Presión sonora (*) (a 2m)	*62 – 72 dBA*
Grado de IP	*IPX4*


(*) Según la norma UNE EN ISO 11201:2010 V2

Dimensiones

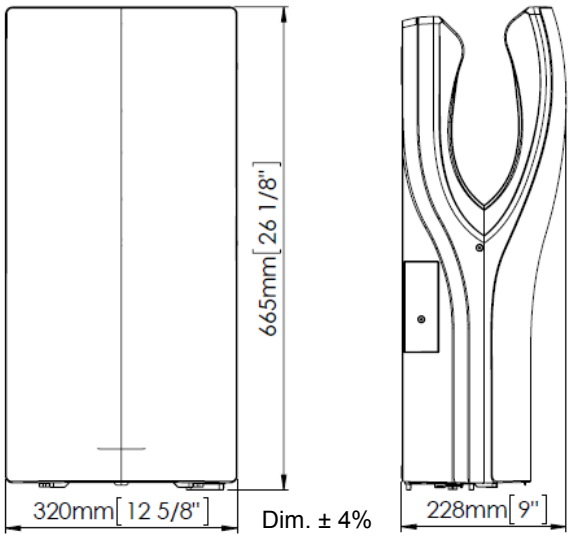


Operación

Colocar las manos al lado de las salidas de aire, dentro de la secadora de manos. La secadora empezará a funcionar automáticamente y lo hará sin interrupción hasta que el usuario quite sus manos de dentro de la máquina. Mover las manos verticalmente hacia arriba y hacia abajo hasta que se sequen completamente. La secadora de manos se apagará automáticamente 2 segundos después de que el usuario quite las manos de dentro de la máquina o después de 30 segundos de funcionamiento continuado.

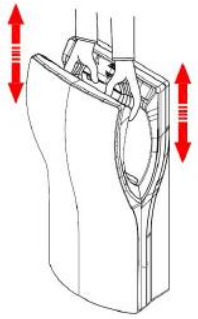

Montaje

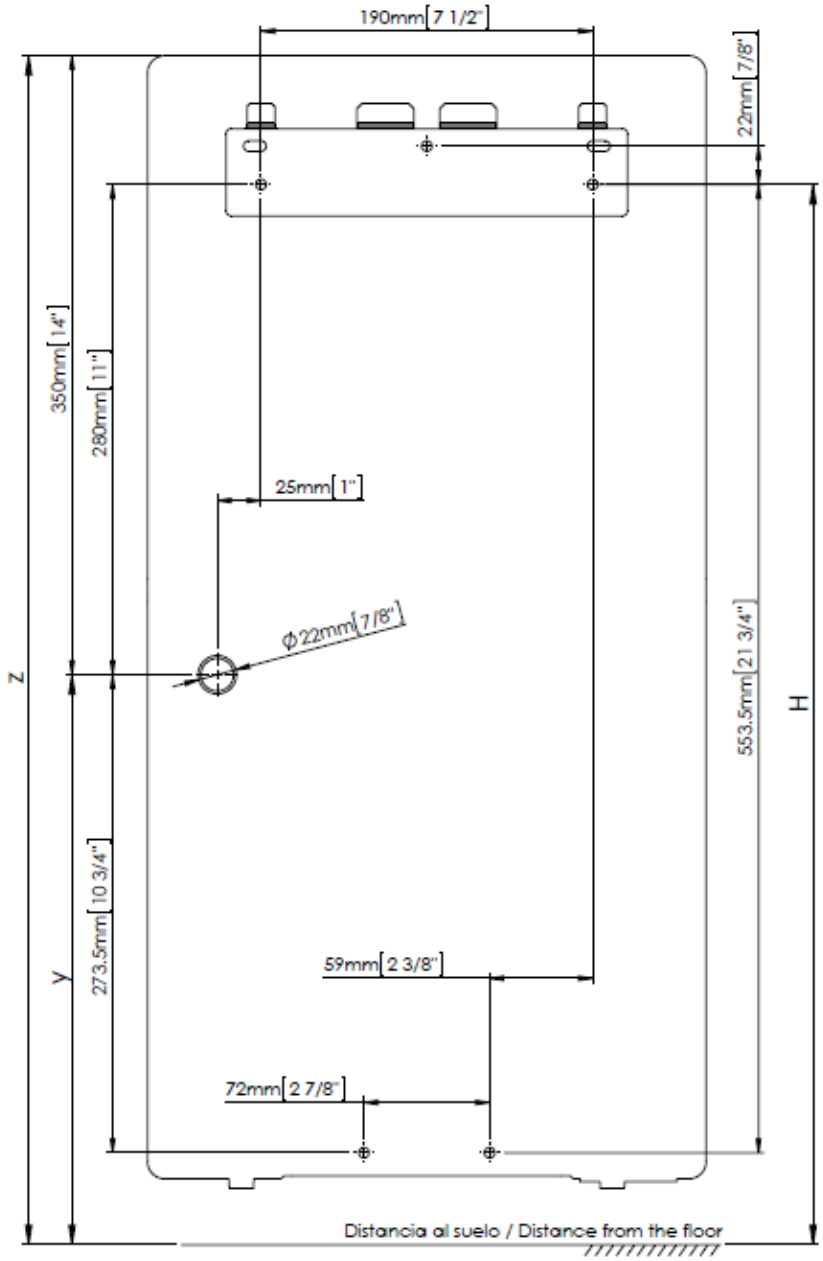

Alturas recomendadas desde el suelo






z =	92 cm (36 1/4")	87 cm (34 1/4")
H =	85 cm (33 1/2")	80 cm (31 1/2")
y =	57 cm (22 1/2")	52 cm (20 1/2")


Conexión al desagüe

1

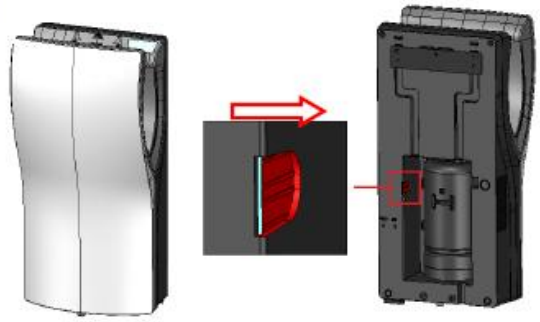


Desprender zona troquelada (zona indicada en la fig.) utilizando botador y martillo.

2

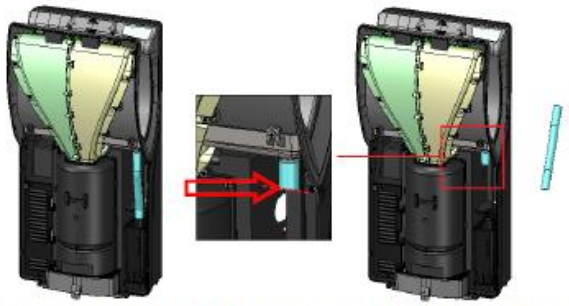


Desmontar el frontal de la secadora y cortar la manguera original enrasando con la pieza de plástico. Conservar trozo pequeño de manguera.

3

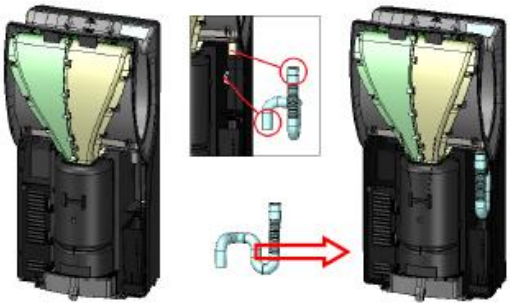


Introducir el extremo del nuevo tubo marcado como “máquina” a través del agujero de la trasera y fijarlo en la salida de agua de la máquina. Para ello NO quitar la parte sobrante de la manguera original.

4

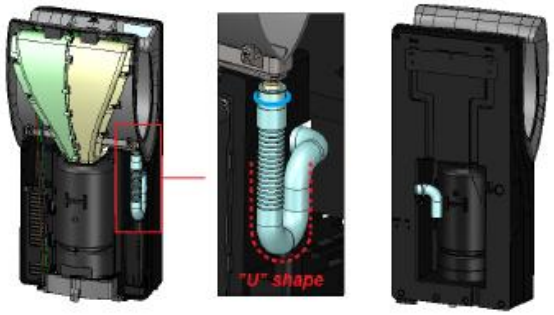

Asegurar que el nuevo tubo mantiene una forma de “U” una vez conectado al desagüe general. Finalmente montar el frontal de la máquina.

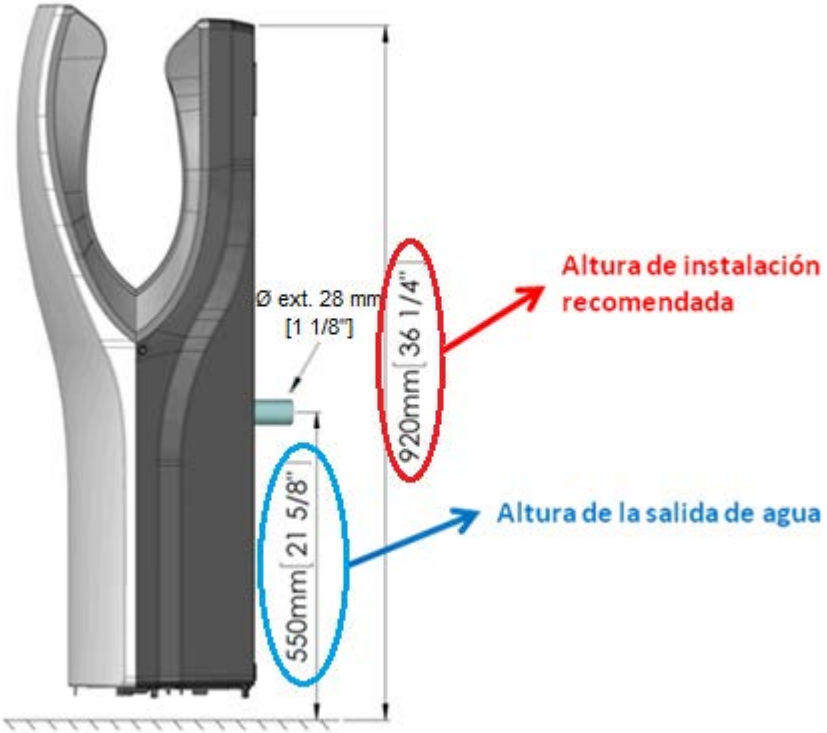

Certificados y homologaciones

Mediclinics, S.A., se reserva el derecho a efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus especificaciones sin previo aviso
Revisión 02-17
.© **medi**clinics S.A.

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

Ficha proporcionada por Tienda del Hostelero — tiendadelhostelero.com